

**CORNEA**  
EDI.8

**Art and Technology  
giving shape to your needs**



**e.janach<sup>®</sup>**  
janach.it

# DALK/BIG BUBBLE DEEP LAMELLAR KERATOPLASTY POCKET DISSECTOR & CANNULAS

J2192.29E  
R. Fogla M.D.



Dissettore per tasca intrastromale, **seziona conica**, per tecnica "BB"

Intrastromal pocket dissector, **conical shaped**, for BIG BUBBLE technique

J2192.30E



Dissettore per tasca intrastromale, **seziona triangolare**, per tecnica "BB"

Intrastromal pocket dissector, **triangle-shaped**, for BIG BUBBLE technique

J2192.31A



Dissettore corneale per DALK, apice triangolare per apertura superiore

DALK corneal dissector, triangle shaped for cutting the cornea

J2641.58



Cannula per iniezione aria, riutilizzabile per tecnica "BB", **27G**, braccio curvo, profilo piatto, foro inferiore 0.40 mm

**27G** Air injection reusable cannula, for **BIG BUBBLE** technique, curved, flat profile, underside port 0.40 mm

J2641.60



Cannula **27G**, flat, foro superiore da 0.4 mm, per somministrazione riboflavina in procedura **CXL SUB-EPITELIALE** e procedura **DALK** per creazione bolla

Cannula **27G**, flat, 0.4 mm upper hole, for application of riboflavin in **SUB-EPITHELIAL CXL** procedure and **DALK** procedure. designed by D. Borroni M.D.

## HOLDER & PROTECTIVE SPATULA

J3350  
P. Rama M.D.



Pinza clamp per fissare i quadranti durante la loro rimozione. Permette una perfetta verticalizzazione del taglio di ogni singolo quadrante

Holder forceps for corneal quadrant removal in DALK procedures. Allows a perfect vertical cut of each quadrant. VIDEO JANACH.IT

# DALK/BIG BUBBLE DEEP ANTERIOR LAMELLAR KERATOPLASTY

## STROMAL DISSECTOR SPATULA

J2192.38A  
P. Rama M.D.



Spatola a disco sottile, bordi smussi, per lo scollamento delle adesioni periferiche durante le tecniche **DALK BIG BUBBLE**. Utile nella fase di rimozione dei quadranti

Disk shaped thin spatula for peripheral delamination of stromal residuals. Useful to perform the removal of the quadrants in **DALK/BIG BUBBLE** procedure

J2192.33A  
A. Galan M.D.



Spatola per delaminazione periferica residui stromali. Sottile, leggermente tagliente, permette una perfetta preparazione del piano stromale periferico prima del posizionamento del lenticolo

Spatula for peripheral delamination of stromal residuals. Thin, semi sharp, allows proper preparation of the peripheral stroma layer prior to the donor lenticle positioning

J2401.1A  
P. Rama M.D.



Spatola per delaminazione tessuto stromale, angolata, braccio curvo da 5 mm. Delicata con bordi semitaglianti, elimina perfettamente le adesioni presenti sul letto stromale

Spatula for delamination of stromal tissue, angled, curved 5mm arm. Delicate with semi sharp edges, totally removes the adhesions of the stromal layer

J2402A  
A. Galan M.D.



Spatola per delaminazione tessuto stromale, angolata, braccio curvo da 10mm. Delicata con bordi semitaglianti, elimina perfettamente le adesioni presenti sul letto stromale

Spatula for the delamination of stromal tissue, angled, curved 10mm arm. Delicate with semi sharp edges, totally removes the adhesions of the stromal layer

J2192.32A  
L. Fontana M.D.



Spatola a disco per scollamento adesioni intrastromali periferiche, per **tecnica BIG BUBBLE**

Disc-shaped spatula for separating intrastromal adhesion, for **BIG BUBBLE technique**.  
VIDEO JANACH.IT

J2329.1A



Spatola DALK, lunghezza 7mm, curva, per completare dissezione cornea

DALK curved spatula, L=7mm, to complete corneal dissection

J2329.2A



Spatola DALK, lunghezza 12mm, curva, per completare dissezione cornea

DALK curved spatula, L=12mm, to complete corneal dissection

J2329.4A



Spatola protezione DESCEMET in DALK BIG-BUBBLE, per tagli radiali

DESCEMET protective spatula in DALK BIG-BUBBLE, for radial cuts

## JDBB01 DALK-BIG BUBBLE DISPOSABLE SET designed by R. Fogla M.D.

5 PER BOX STERILE

### set composto da/composed set:

cannula DALK da iniezione, monouso 27G (BIG BUBBLE) / disposable DALK air injection cannula 27G (BIG BUBBLE)  
dissettore monouso per tasca intrastromale, sezione conica, per tecnica "BB" / disposable intrastromal pocket dissector, conical shaped, for "BB" technique



## JDBB00 BIG BUBBLE JANACH DISPOSABLE SET

5 PER BOX STERILE

### set composto da/composed set:

cannula DALK da iniezione, monouso 27G (BIG BUBBLE) / disposable DALK air injection cannula 27G (BIG BUBBLE)  
dissettore monouso per tasca intrastromale, sezione triangolare, per tecnica "BB" / intrastromal pocket dissector, triangle-shaped, for "BB" technique



## BIG BUBBLE 27G CANNULA MONOUSO/DISPOSABLE

10 PER BOX STERILE

SG211050



Cannula DALK big-bubble da iniezione aria,  
piatta **27G foro inferiore da 0.4 mm**



**27G** air injection big-bubble flat cannula, **0.4 mm lower port**



# DSEK/DSAEK DESCemet STRIPPING ENDOTHELIAL KERATOPLASTY INSTRUMENTS

## designed by C. Macaluso M.D.



### J3760.1

#### DSEK/DSAEK

(for 4.0 mm incision)

#### sealing plunger



Inseritore di lenticolo endoteliale DSEK/DSAEK, con chiusura ermetica e aletta di caricamento laterale. Il sistema dotato di stantuffo sigillante chiude ermeticamente il cono di inserzione a becco di flauto dove il lenticolo viene caricato e avvolto. Il caricamento ed avvolgimento nel cono è effettuato con la pinza coassiale J3862.23L, utilizzata anche nell'inserimento del lenticolo in camera anteriore. Rispetto ai tradizionali sistemi di inserimento il modello Macaluso, grazie alla chiusura ermetica, non permette passaggio di aria nel cono. Questo mantiene una pressione stabile in camera anteriore, evitando il collasso e facilitando la fase delicata di inserimento del lenticolo. Per lenticolo **superiore > 180 micron**

DSEK/DSAEK endothelial lenticle inserter with sealing and side loading winglet. The system, equipped with sealing plunger, allows to seal the beveled cone where the lenticle is loaded and folded. The loading and folding action inside the cone is performed using the coaxial forceps J3862.23L, also used while inserting the lenticle into the anterior chamber.

Compared to conventional inserter guide systems, being the Macaluso an hermetic sealing device, it does not allow passage of air inside the cone. This maintains a stable pressure avoiding collapse of the anterior chamber making the insertion of the lenticle easy. **for lenticle thickness over > 180 micron**

### J3760.2

#### DSEK/DSAEK

#### ultra-thin

(for 3.5 mm incision)


Inseritore per DSEK/DSAEK con sistema sigillante per lenticolo endoteliale sottile **inferiore < ai 180 micron**. I modelli sono entrambi smontabili per una accurata manutenzione e pulizia nel post intervento

Ultra-thin, DSEK/DSAEK endothelium inserting device, for lente thickness, **below < 180 micron**

Both models can be disassembled for proper post-op cleaning and maintenance



### J3862.23L



Pinza per DSEK/DSAEK coassiale atraumatica, **23G**, per caricamento ed inserimento del lenticolo endoteliale.

Da utilizzare con gli inseritori **J3760.1 e J3760.2**

DSEK/DSAEK 23G coaxial forceps for loading and inserting the endothelial lenticle. Atraumatic tips, slightly curved. To be used with Macaluso inserter **J3760.1 and J3760.2**



### J3862.25L



Pinza per inserimento lenticolo in DSEK, versione da **25G**

DSEK forceps for lenticle inserter, version **25G**

## SLIDING GUIDE

### J3761



Guida per inserimento lenticolo in DSEK/DSAEK **con aletta di caricamento** per incisione da **4.0 mm**

Sliding guide for lenticle, for DSEK/DSAEK **with lateral loading winglet** for **4.0 mm** incision. Designed by M. Busin M.D.



### J3760



Guida per inserimento lenticolo in DSEK/DSAEK **senza aletta di caricamento** per incisione da **4.0 mm**

Sliding guide for lenticle, for DSEK/DSAEK **without winglet** for **4.0 mm** incision. Designed by M. Busin M.D.

# DSEK/DSAEK DESCemet STRIPPING ENDOTHELIAL KERATOPLASTY SCORING TOOLS



J3156

Pietro Viola M.D.

## DESCEMETORESSI ONE STEP


La pinza ONE STEP permette di eseguire in azione combinata, le due fasi di scoring e stripping, nella procedura DESCemetOressi. Le ridotte dimensioni, la geometria delle punte, unita alla convessità dello stelo, consentono facile accesso e gestione della pinza in ogni condizione all'interno della camera anteriore. Anche in occhi fachici, dove è richiesta massima attenzione, si ha sempre la percezione di operare in totale sicurezza senza alcun rischio di toccare il cristallino. Il fulcro coassiale mantiene costante la stabilità della pressione in C.A. se l'incisione di accesso viene eseguita con taglienti di calibro corretto in relazione al fulcro di 23G

This ONE-STEP forceps allows to perform at the same time the scoring and stripping of the Descemet Membrane in DSAEK and DMEK procedures. The small dimensions and the geometry of the tips, combined with the convexity of the shaft, allow easy access and management of the forceps in Anterior Chamber. Even in phakic eyes, where maximum attention is required, you always have the feeling of operating in total safety without any risk of touching the crystalline lens. The coaxial fulcrum allows to keep a constant pressure in the A.C. when the access incision is performed with 23G cutting device. [VIDEO JANACH.IT](#)



J3157

A. Galan M.D.



Pinza "scoring" cross-action per endoressi della membrana di Descemet in tecnica DSEK/DSAEK per incisione da 1.8 mm

**DSEK/DSAEK** cross-action endorrhexis "scoring" forceps to remove the Descemet membrane, for 1.8 mm incision. [VIDEO JANACH.IT](#)



J2183.10E



Uncino "scoring" per **DSEK/DSAEK** acuto, angolato

**DSEK/DSAEK** "scoring" hook sharp, angled



J2183.11A



Uncino per stripping membrana di Descemet in **DSEK**

Hook for stripping Descemet's membrane in **DSEK**



J2183.12A



Uncino stripper per **DSEK/DSAEK** apice a "T" per rimuovere la membrana di Descemet

**DSEK/DSAEK** stripper, "T" shaped tip to remove the Descemet membrane



J2183.18A



## DOPPIO UNCINO PER DMEK/DSEK

Doppio uncino per stripping della membrana di Descemet nel paziente e per clivaggio/peeling su cornea donatore

## DOUBLE ENDED HOOK FOR DMEK/DSEK

Double ended hook for the stripping of the recipient's Descemet membrane and for the cleavage/peeling of the donor cornea

# DALK SET designed by V. Sarnicola M.D.



## J2641.74

Cannula DALK 27G, foro inferiore, leggermente curva, per iniezione aria

DALK 27G cannula, lower bore, slightly curved, for air injection

Designed by V. Sarnicola M.D.



## J2112.1E HOCKEY-SPATULA

Micro spatula con profilo trattato smusso. Utile nella preparazione del lenticolo donatore per determinare il clivaggio nella fase che precede lo scollamento del piano pre-descemetico. La spatola consente di controllare correttamente lo scollamento periferico dei piani in entrambe le procedure di preparazione: DALK e DMEK

Micro spatula with beveled edges. Useful in the preparation of the donor lenticle to outline the cleavage prior to the detachment of the pre-descemetic plane. The spatula allows you proper control of the peripheral detachment of the planes in both DALK and DMEK procedures

Designed by V. Sarnicola M.D.



## J2192.28E FLARED SPATULA

Micro spatula con dorso leggermente curvo a sezione rastremata, apice smusso.

. Creazione del tunnel intra-stromale in tecnica DALK Big-Bubble. Crea un tunnel lineare e controllato per accogliere la cannula da 27G garantendo una

tenuta ermetica, importante nella collocazione e stabilità della cannula durante l'iniezione della bolla d'aria.

. Scollamento e dissezione completa del piano pre-descemetico in tecnica DALK/DMEK previa fase di clivaggio con la Hockey spatula

. Manipolazione e gestione durante l'apertura del ROLL in Camera Anteriore nella tecnica DMEK

Thin micro spatula with slightly curved back and tapered section with blunt tips.

. Creation of the intra-stromal tunnel in DALK Big-Bubble technique. Creates a perfectly shaped tunnel to accommodate the 27G cannula, guaranteeing

an accurate sealing; critical in the stable placement of the cannula during the air bubble injection.

. Detachment and complete dissection of the pre-descemetic plane in DALK/DMEK technique after performing cleavage with the Hockey spatula.

. Easy handling and management while opening the ROLL in the Anterior Chamber in DMEK technique

Designed by V. Sarnicola M.D.



## J2290.21

Doppio marcatore centro ottico Ø 8 e Ø 9 mm

Double ended optic zone marker, Ø 8 mm and Ø 9 mm

Designed by V. Sarnicola M.D.

# DMEK SET designed by V. Sarnicola M.D.



## J2897E

Pinza stripping/peeling per lenticolo del donatore, presa delicata anatomica  
stripping/peeling forceps for donor lenticle, delicate grip  
Designed by V. Sarnicola M.D.



## J3861.23

Pinza coassiale con tip atraumatica. Utilizzata per la gestione del roll in procedura DMEK,  
durante l'inserimento e la manipolazione in camera anteriore. Presa perpendicolare rispetto alla chiusura del manico  
23G coaxial forceps with atraumatic tip - used in DMEK for roll management, while inserting and handling lenticle  
in the anterior chamber. Squeezing direction of the handle is perpendicular to the closing action of tips



## J2290.20

Doppio marcatore centro ottico Ø 7.5 e Ø 8.5 mm  
Double ended optic zone marker, Ø 7.5 mm and Ø 8.5 mm  
Designed by V. Sarnicola M.D.



## J2641.71

Cannula DMEK 27G, per apertura lenticolo, foro superiore  
27G DMEK cannula for lenticle opening, upper port  
Designed by V. Sarnicola, MD



## J2641.72

Cannula DMEK 27G, per apertura lenticolo, foro destro  
27G DMEK cannula for lenticle opening, port at right side  
Designed by V. Sarnicola, MD



## J2641.73

Cannula DMEK 27G, per apertura lenticolo, foro sinistro  
27G DMEK cannula for lenticle opening, port at left side  
Designed by V. Sarnicola M.D.



# MIDI micro incision descemet inserter

## designed by V. Sarnicola M.D.


### JD0012

E' il nuovo sistema di inserimento del lenticolo Descemet per procedura DMEK a distanza di molti anni dall'uscita sul mercato del primo dispositivo.

L'innovazione e' da sempre presente nel nostro DNA, perche' capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La nostra forza e tenacia ci ha sempre condotti e guidati con spirito innovativo.

I risultati raggiunti ci hanno permesso di conquistare la fiducia dei clienti sul mercato internazionale.

It is a new Descemet lenticle insertion system for DMEK procedures following our first device launched years ago. Innovation is part of our DNA, it enables us to respond to the needs of a market in continuous evolution. Our strength and persistence has always guided us with an innovative spirit. The results we have achieved have allowed us to win the trust of our customers in international markets.

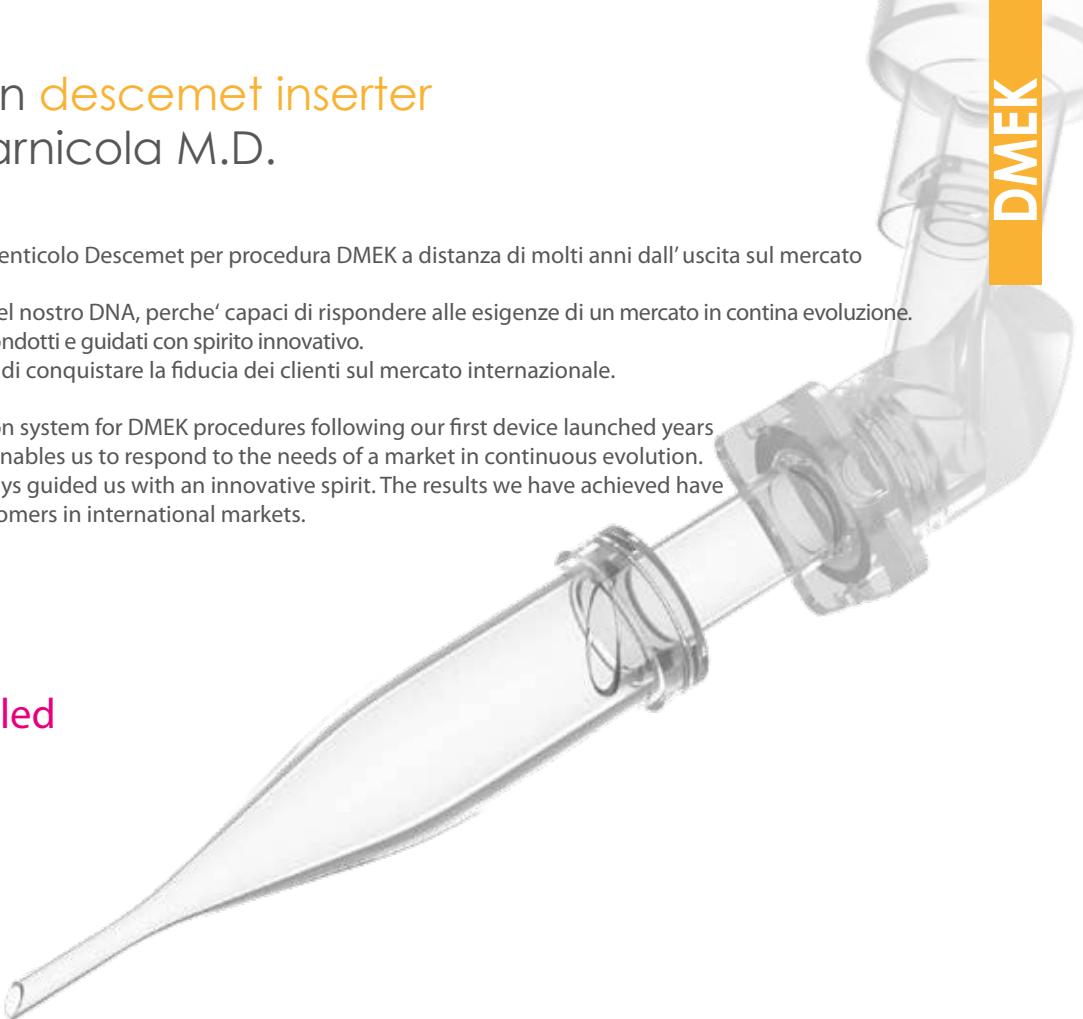

### CARATTERISTICHE e VANTAGGI/FEATURES and ADVANTAGES

- .Ergonomia e semplicità d'introduzione del lenticolo in camera anteriore grazie alla trasparenza del vetro e all'angolazione del device.
- .Cartridge con sistema di rotazione a 180°
- .Controllo del flusso attraverso il filtro "flow controller"
  
- .Ergonomics and easy introduction of the graft into the anterior chamber thanks to the transparency of the glass and the angle of the device.
- .Cartridge with 180 ° rotation system
- ."flow controller" filter for flow control

### DUE STEPS PER L'INSERIMENTO/TWO STEPS INSERTION


Nella **prima fase** il contenitore centrale cattura e accoglie facilmente il roll (DM) attraverso una delicata aspirazione controllata grazie a un filtro che previene ed evita il passaggio del roll all'interno della siringa.

Nella **seconda fase** il sistema "MIDI" prevede l'accoppiamento del cartridge con il contenitore centrale.


Caratteristica fondamentale, è il sistema rotativo, che permette di orientare correttamente il roll prima dell'inserimento.

In the **first stage** the central container easily captures and accommodates the roll (DM) through a gentle controlled suction thanks to a filter that prevents the accidental passage of the roll inside the syringe.

In the **second stage** the cartridge is coupled with the central container. A key feature of the "MIDI" system is the rotational system, which allows operator to correctly orient the roll before insertion.

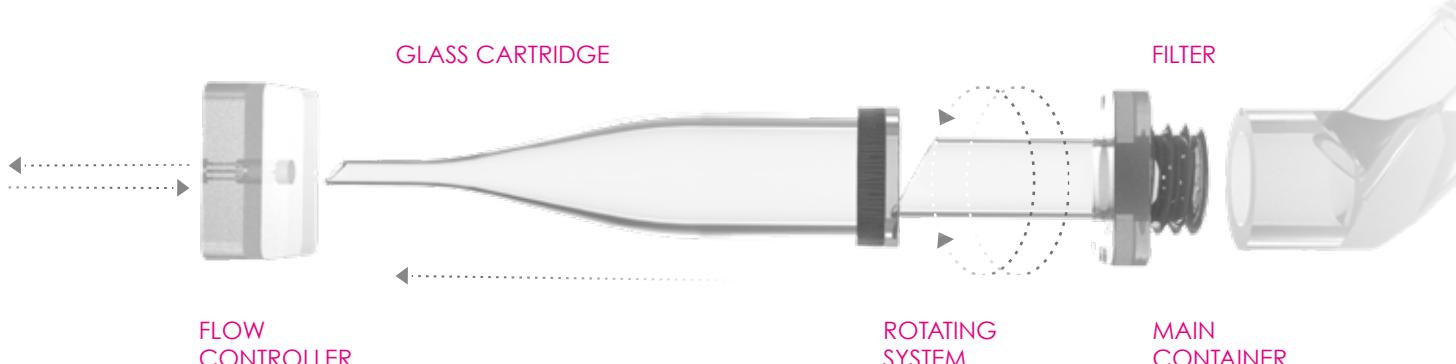


JCP0011.1

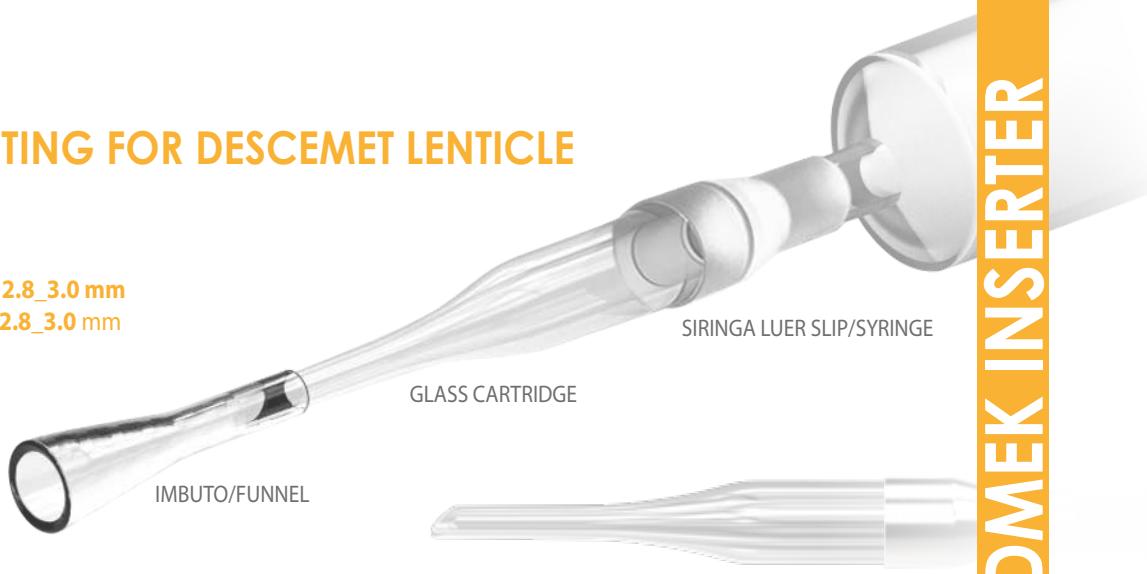**DISPOSABLE INSERTING FOR DESCemet LENTICLE****BEST SELLER★****FEATURES:****PER INCISIONI CONVENZIONALI 2.8\_3.0 mm****FOR CONVENTIONAL INCISIONS 2.8\_3.0 mm**


Il nuovo sistema basato, come concetto sul precedente kit di inserimento roll DMEK presentato nel 2013, migliora ed agevola la cattura del roll precedentemente "strappato" direttamente sul piatto di suzione del punch creato per la preparazione del roll che, immerso successivamente in soluzione bilanciata (BSS), verrà attraverso il cono applicato all'apice del cartridge, aspirato e convogliato agevolmente all'interno nel cartridge. Conclusa la fase di aspirazione del roll e verificando che sia stato correttamente posizionato nel cartridge, il cono verrà rimosso lasciando il sistema pronto per l'inserimento del lenticolo. Il cartridge potrà così essere inserito nella piccola incisione corneale attraverso la quale il roll verrà iniettato con la massima sicurezza e precisione. Kit fornito completo di siringa, adattatore plastico, cartridge e cono di aspirazione.

The new system based on the same concept of the previous DMEK roll insertion kit introduced in 2013, improves and facilitates the capture of the lenticle previously "stripped" directly on the base of the suction punch used for its preparation. The roll, later soaked in balanced solution (BSS), will be easily aspirated inside the cartridge through the cone applied on the cartridge. Once the roll has been correctly positioned inside the cartridge, the cone will be removed leaving the system ready for delivery. The cartridge can then be inserted into the small corneal incision through which the roll will be injected with maximum safety and precision.

The kit includes syringe, plastic adapter, cartridge and suction funnel

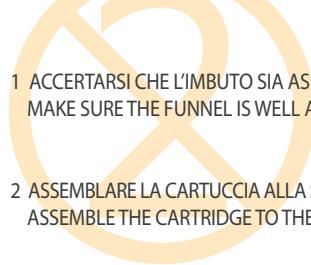

**1 ACCERTARSI CHE L'IMBUTO SIA ASSEMBLATO AL CARTRIDGE  
MAKE SURE THE FUNNEL IS WELL ASSEMBLED TO THE CARTRIDGE**

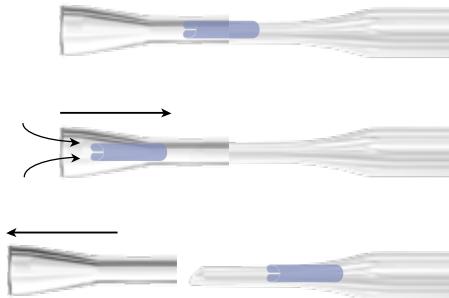

**2 ASSEMBLARE LA CARTUCCIA ALLA SIRINGA CON UNA PRESSIONE TALE DA RENDERE STABILE L'ACCOPPIAMENTO  
ASSEMBLE THE CARTRIDGE TO THE SYRINGE WITH A PRESSURE SUCH THAT THE COUPLING IS STABLE**

**3 ASPIRARE DELICATAMENTE IL LENTICLO ATTRAVERSO L'IMBUTO FINO A CHE NON GIUNGA  
NELLA ZONA CENTRALE DEL BECCUCCIO PER INIEZIONE  
GENTLY ASPIRATE THE LENTICLE THROUGH THE FUNNEL UNTIL IT REACHES THE CENTER OF THE INJECTION SPOUT**



**4 RIMUOVERE L'IMBUTO / REMOVE THE FUNNEL**

**5 INTRODURRE IL BECCUCCIO PER INIEZIONE NELL'INCISIONE ED INIETTARE IL LENTICLO  
INSERT THE INJECTION SPOUT INTO THE INCISION AND INJECT THE LENTICLE**

**JCP0011.2 SMALL INCISION****FEATURES:****PER PICCOLE INCISIONI 2.3\_2.5 mm****FOR SMALL INCISIONS 2.3\_2.5 mm**

## ONE-STEP YOGURT TECHNIQUE

### FACILE/EASY

Il taglio del punch si estende fino alla linea di Schwalbe, dove la membrana di Descemet si stacca molto facilmente.  
 Trephination extends up to schwalbe's line in the periphery where dm is very easily peeled off.  
 The technique resembles, thus, the opening of a yogurt cup creating a hinge to grasp the graft

### SICURO/SAFE

Nessuna perdita di cellule endoteliali in quanto tutte le manipolazioni sono fatte solo su tessuto in eccesso che funge anche da indicatore di orientamento lenticolo

#### Niente più innesto a testa in giù

No endothelial cell loss as all manipulations are made only on excess tissue which also acts as an orientation marking.

**No more upside-down placed graft**

### VELOCE/QUICK


La preparazione viene eseguita con la tecnica single-peel in meno di 5 minuti  
*Preparation is performed in a single-peel technique in less than 5 minutes*

### CONVENIENTE/AFFORDABLE

Non sono necessari strumenti speciali o punzoni corneali multipli  
 No need for special instrumentation or multiple corneal punches

### FALLO DA SOLO/DO IT YOURSELF

Crea il tuo innesto in sala operatoria, curva di apprendimento molto bassa  
 Create your graft in operating theatre, very low learning curve

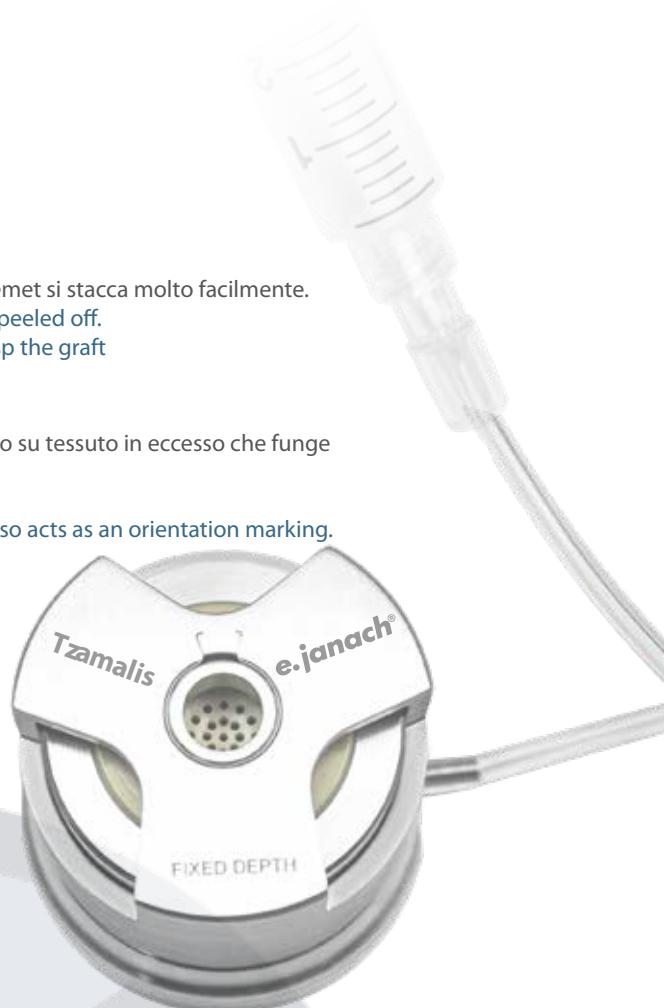

**FIXED DEPTH**  
**available size**

JD 700 TZ Ø 7.0  
 JD 750 TZ Ø 7.5  
 JD 800 TZ Ø 8.0  
 JD 850 TZ Ø 8.5  
 JD 900 TZ Ø 9.0



PUNCH



UNPEEL FROM  
THE "TAB" & MARK



HARVEST DMEK GRAFT



## EYE BANKING DMEK PUNCH

DMEK punch a suzione, **lama calibrata da 100 µ, Ø10.0mm, MONOUSO,** vacuum DMEKpunch **100 µ calibrated blade, Ø10.0mm, DISPOSABLE**



### Descrizione / Description

1. Lama Ø10.0 mm, profondità di taglio calibrata 100 µ / 1. Punch blade Ø 10.0 mm with calibrated depth 100 µ
2. Base / Support
3. Raccordo / Syringe tubing
4. Siringa 5 cc con molla / 4. 5 cc spring syringe

### Caratteristiche / Unique features

- Sistema di centraggio della cornea  
• Cornea centering system
- Profondità di taglio a 0.10 mm che consente di individuare la Descemet velocemente, in modo sicuro ed efficace
  - 0.10 mm fixed-cutting depth allows safe and quick detection of the Descemet Membrane
- Sistema ripetibile ed indipendente dall'operatore
  - Predictable and reproducible system, does not depend on the operator
  - Mortalità cellulare indotta dalla procedura assente
    - No induced cellular mortality

La procedura DMEK è un nuovo traguardo nella chirurgia lamellare profonda. Grazie alla preziosa collaborazione iniziata con il Dott. R. Fogla, il nostro centro di ricerca ha sviluppato ed introdotto fra i primi un sistema a suzione per questa affascinante procedura. Un nuovo progetto basato su analogo sistema, nato con la collaborazione tecnico-scientifica della **Banca degli Occhi di Mestre**, ha creato un innovativo donor punch in grado di semplificare la procedura di preparazione del lenticolo all'interno delle Banche degli Occhi.

DMEK is the latest accomplishment in deep lamellar surgery. Thanks to the valuable collaboration started with Dr. R. Fogla, our R & D department has been among the first developers of an innovative suction system for this fascinating procedure. A new project, based on a similar system, developed with the scientific collaboration of the **Mestre Eye Bank**, has given birth to a new concept of donor punch with peculiar features that facilitate lenticle preparation in Eye Banks.

Nuovo sistema di aspirazione potenziato grazie a un innovativo zoccolo di suzione e nuovo disegno del punzone permette un facile e preciso taglio sotto il controllo visivo del chirurgo.

NEW enhanced donor vacuum trephine. Innovative design allows the surgeon to perform a precise and easy cutting under visual control.

## DMEK PUNCH MISURE ADDIZIONALI/ADDITIONAL SIZES

### DMEK punch 100 µ calibrated blade

#### JD2890FD.775

DONOR PUNCH **Ø7.75 mm**, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 µ, per membrana di Descemet  
DONOR PUNCH **Ø7.75 mm**, CALIBRATED BLADE 100 µ, for Descemet membrane

#### JD2890FD.800


DONOR PUNCH **Ø8.00 mm**, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 µ, per membrana di Descemet  
DONOR PUNCH **Ø8.00 mm**, CALIBRATED BLADE 100 µ, for Descemet membrane

#### JD2890FD.825

DONOR PUNCH **Ø8.25 mm**, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 µ, per membrana di Descemet  
DONOR PUNCH **Ø8.25 mm**, CALIBRATED BLADE 100 µ, for Descemet membrane

#### JD2890FD.850

DONOR PUNCH **Ø8.50 mm**, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 µ, per membrana di Descemet  
DONOR PUNCH **Ø8.50 mm**, CALIBRATED BLADE 100 µ, for Descemet membrane

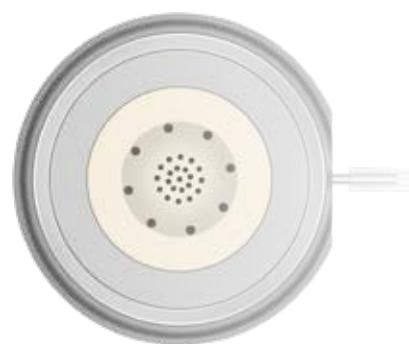

# PUNCH A SUZIONE MONOUSO PER DONATORE-TAGLIO A TOTALE SPESSORE DISPOSABLE CUTTING THROUGH VACUUM DONOR PUNCH

Nuovo sistema di aspirazione potenziato grazie a nuova geometria creata sulla base di suzione.  
Il nuovo disegno del punzone permette un facile e preciso taglio sotto il controllo visivo del chirurgo

The new enhanced suction system and an innovative design of the blade allows the surgeons to perform a precise cut of the lenticle under constant visual control by the surgeons

<b>JD2890.600</b>	punch con lama, Ø 6.00 mm punch with blade, Ø 6.00 mm
<b>JD2890.625</b>	punch con lama, Ø 6.25 mm punch with blade, Ø 6.25 mm
<b>JD2890.650</b>	punch con lama, Ø 6.50 mm punch with blade, Ø 6.50 mm
<b>JD2890.675</b>	punch con lama, Ø 6.75 mm punch with blade, Ø 6.75 mm
<b>JD2890.700</b>	punch con lama, Ø 7.00 mm punch with blade, Ø 7.00 mm
<b>JD2890.725</b>	punch con lama, Ø 7.25 mm punch with blade, Ø 7.25 mm
<b>JD2890.750</b>	punch con lama, Ø 7.50 mm punch with blade, Ø 7.50 mm
<b>JD2890.775</b>	punch con lama, Ø 7.75 mm punch with blade, Ø 7.75 mm

<b>JD2890.800</b>	punch con lama, Ø 8.00 mm punch with blade, Ø 8.00 mm
<b>JD2890.825</b>	punch con lama, Ø 8.25 mm punch with blade, Ø 8.25 mm
<b>JD2890.850</b>	punch con lama, Ø 8.50 mm punch with blade, Ø 8.50 mm
<b>JD2890.875</b>	punch con lama, Ø 8.75 mm punch with blade, Ø 8.75 mm
<b>JD2890.900</b>	punch con lama, Ø 9.00 mm punch with blade, Ø 9.00 mm
<b>JD2890.925</b>	punch con lama, Ø 9.25 mm punch with blade, Ø 9.25 mm
<b>JD2890.950</b>	punch con lama, Ø 9.50 mm punch with blade, Ø 9.50 mm



# PUNCH SENZA SUZIONE MONOUSO PER DONATORE-TAGLIO A TOTALE SPESSORE DISPOSABLE CUTTING THROUGH DONOR PUNCH NO VACUUM

<b>JD2899.600</b>	punch con lama, Ø 6.00 mm punch with blade, Ø 6.00 mm
<b>JD2899.625</b>	punch con lama, Ø 6.25 mm punch with blade, Ø 6.25 mm
<b>JD2899.650</b>	punch con lama, Ø 6.50 mm punch with blade, Ø 6.50 mm
<b>JD2899.675</b>	punch con lama, Ø 6.75 mm punch with blade, Ø 6.75 mm
<b>JD2899.700</b>	punch con lama, Ø 7.00 mm punch with blade, Ø 7.00 mm
<b>JD2899.725</b>	punch con lama, Ø 7.25 mm punch with blade, Ø 7.25 mm
<b>JD2899.750</b>	punch con lama, Ø 7.50 mm punch with blade, Ø 7.50 mm

<b>JD2899.800</b>	punch con lama, Ø 8.00 mm punch with blade, Ø 8.00 mm
<b>JD2899.825</b>	punch con lama, Ø 8.25 mm punch with blade, Ø 8.25 mm
<b>JD2899.850</b>	punch con lama, Ø 8.50 mm punch with blade, Ø 8.50 mm
<b>JD2899.875</b>	punch con lama, Ø 8.75 mm punch with blade, Ø 8.75 mm
<b>JD2899.900</b>	punch con lama, Ø 9.00 mm punch with blade, Ø 9.00 mm
<b>JD2899.925</b>	punch con lama, Ø 9.25 mm punch with blade, Ø 9.25 mm
<b>JD2899.950</b>	punch con lama, Ø 9.50 mm punch with blade, Ø 9.50 mm



# DMEK “PULL-THROUGH” technique (endo-in)

by Busin M.D.



**J2895E**



Pinza per piegare e posizionare nel cartigde di inserimento la membrana di Descemet prelevata dal donatore. I punti di presa equidistanti minimizzano il contatto con la sottile membrana evitando danni o perdita di cellule endoteliali

DMEK forceps for folding and positioning the donor lenticule inside the loading cartridge. The tips have been optimized in order to minimize contact with the membrane and thus avoiding endothelial cell loss. VIDEO JANACH.IT

**J3863.23L**



Pinza coassiale per la manipolazione del lenticolo nella tecnica DMEK “PULL-THROUGH” (prelievo, caricamento nel cartridge e trascinamento in camera anteriore). Punta fine che minimizza la traumatizzazione del tessuto

Coaxial forceps for holding the lenticle in DMEK “PULL-THROUGH” technique (picking, loading and pulling in the anterior chamber). Very fine atramautic tips for lenticle safety

**J2896E**



Spatola per scoring e stripping del lembo endoteliale del ricevente, per tecnica DMEK. La particolare geometria arrotondata dell'apice consente una facile azione di scoring evitando strappi e interruzione nel taglio della membrana

DMEK scraper spatula, for scoring and stripping of recipient eye

**J2649.10**



Mantenitore di camera anteriore spatalato, **23G** ( $\varnothing 0.6$ ), con scanalature per mantenere stabilità nell'incisione. Foro inferiore che garantisce una fluidodinamica ottimale in presenza di lenticolo, nella procedura DMEK. L'infusione inferiore riduce al minimo i movimenti indesiderati del delicato lenticolo che possono essere invece provocati da una infusione classica

**23G** ( $\varnothing 0.3$ ) spatulated anterior chamber maintainer, with grooves to improve steadiness. Lower port grants improved lenticle fluids dynamics in DMEK procedures. Lower hole infusion reduces dramatically unwanted lenticle motion which is definitely present with a standard infusion

## ANTERIOR CHAMBER MAINTAINER

**J2649.7**



Mantenitore di camera anteriore, **20G/23G**, inserzione atraumatica, autobloccante titanio

**20G** anterior chamber maintainer, self-retaining, atraumatic insertion, titanium

**J2649.8**



Mantenitore di camera anteriore, **23G**, inserzione atraumatica, autobloccante, titanio

**23G** anterior chamber maintainer, self-retaining, atraumatic insertion, titanium

**J2649.9**



Mantenitore di camera anteriore, **25G** ( $\varnothing 0.5$ ) specifico per procedure **DSEK** e **DMEK**

**25G** ( $\varnothing 0.5$ ) anterior chamber maintainer, specific for **DMEK** and **DSEK** procedures

**JD93768**



Mantenitore di camera anteriore, **20G monouso** **5 PER BOX STERILE**

**20G** anterior chamber maintainer, self-retaining, **disposable**

**JD93769**



Mantenitore di camera anteriore, **23G monouso** **5 PER BOX STERILE**

**23G** anterior chamber maintainer, self-retaining, **disposable**

# DMEK TOOLS by A. Caporossi M.D.

## J2641.70



Cannula **23G** piatta a 3 fori laterali, per distensione delicata del lenticolo in DMEK. I tre fori sono calibrati per ottenere un flusso omogeneo per distendere il lenticolo delicatamente e uniformemente. Una volta inserito il roll in camera anteriore, la cannula a sezione piatta, viene posizionata all'interno del lume e grazie al flusso in uscita dai fori laterali permette una dolce distensione e apertura del lenticolo

**23G** flat tip cannula with 3 side ports, for gently unfolding the lenticle in DMEK procedures.

The 3 ports are dimensioned in order to reach a constant flow to unroll the lenticle gently and uniformly. Once the roll is inserted in the anterior chamber, the flat tip cannula is positioned inside the lumen and thanks to a delicate constant flow allows a gentle unrolling of the lenticle itself

VIDEO JANACH.IT

## DMEK I/A SCORING/STRIPPING



## J2183.15A



Cannula **DSEK/DSAEK 23G**, per aspirazione e rimozione del lenticolo endoteliale dotata di uncino smusso per la fase di scoring. L'uncino smusso fissato nel punto distale della cannula esegue lo scoring sull'endotelio. Ultimata la fase di scoring, il foro di aspirazione cattura il lenticolo endoteliale rimuovendolo delicatamente in un unico step

**DSEK/DSAEK 23G**, scoring hook and aspirating handpiece. The blunt hook, positioned on the distal part of the cannula, performs the scoring on the endothelium. Once the scoring is performed, aspiration action can be started so that the aspirating port can capture the endothelial lenticle removing it gently in a single step



## J2183.16A



Uncino irrigante per **SCORING, 23G, foro inferiore**, per DMEK. L'azione irrigante consente di mantenere tono e volume in camera anteriore senza la necessità di utilizzare un mantenitore e dunque di creare un'ulteriore incisione

**23G** Irrigating hook, **lower port**. For the **SCORING** of the endothelium in DMEK procedure. Irrigation allows stable anterior chamber and avoids additional incision for chamber maintainer



## J2183.17A



Uncino irrigante per **STRIPPING, 23G, foro inferiore**, per DMEK. L'azione irrigante consente di mantenere tono e volume in camera anteriore senza la necessità di utilizzare un mantenitore di camera e dunque di creare un'ulteriore incisione

**23G** Irrigating hook, **lower port**. For the **STRIPPING** of the endothelium in DMEK procedure. Irrigation allows stable anterior chamber and avoids additional incision for chamber maintainer



## J2641.55 Figini M.D.



Cannula **27G** per DLK tecnica BIG BUBBLE, piatta, braccio 12 mm, Ø 0.40 mm, foro inferiore da Ø 0.30 mm

**27G** DLK cannula for BIG BUBBLE procedure, 12 mm angle to tip, 30 G underside port

# PDEK DONOR CLAMP by H. Dua M.D.

J3516



Clamp corneale per la preparazione del lenticolo donatore nella tecnica PDEK. Per la preparazione si inietta una bolla d'aria tra gli strati stromali. La bolla si propaga andando a separare gli strati interessati al trapianto. Il clamp serve per limitare la propagazione della bolla oltre al limite necessario ( $\varnothing$  9.0 mm) per facilitare la successiva preparazione del lenticolo

Corneal clamp for donor lenticle preparation in PDEK technique. An air bubble is injected between the stromal layers, the bubble will expand so to separate the layers involved in the transplantation. The clamp is used to keep the bubble under control in order to avoid exceeding the limit of  $\varnothing$  9.0 mm thus easing the preparation of the lenticle

# DMEK INSTRUMENTS designed by Fogla M.D.

J2892E



## Pinza stripping/peeling DMEK per membrana di Descemet, presa delicata anatomica

La pinza con branche anatomiche affera al margine la membrana fissata sul supporto a suzione che dolcemente viene scollata sotto un'azione di peeling. Il lenticolo scollato viene poi immerso nella soluzione prima di essere inserito nel paziente. Lo scollamento del margine si ottiene utilizzando l'uncino di clivaggio J2891E

VIDEO JANACH.IT

## DMEK Stripping/peeling forceps for Descemet membrane, delicate anatomically designed tips

Forceps with tips anatomically designed for the stripping/peeling of the delicate Descemet membrane. The forceps grasp the membrane at the edge and perform the detachment of the Descemet lenticle by means of a peeling action. At this step the membrane is secured to its support by the suction system. Cleavage of the membrane is performed with the Fogla hook J2891E



J2891E



## Uncino per clivaggio DMEK per membrana di Descemet

L'uncino di sezione triangolare con apice atraumatico svolge la funzione di clivaggio al margine del lenticolo precedentemente fissato sulla base a suzione. Una volta sollevata la membrana di Descemet, la pinza J2892E completa il peeling della DM. VIDEO JANACH.IT

## DMEK cleavage hook for Descemet membrane

Delicate blunt hook for Descemet membrane cleavage. The Fogla hook, with atraumatic tips, triangular shaped, performs the cleavage at the edges, of the lenticle previously secured to the suction DMEK support. Once the, correct thickness of the pure Descemet membrane is achieved, the Janach, forceps J2892E performs the detachment by means of the peeling action



J2893E



## Marcatore a forma di F per DMEK linea EVO

**Marcatore a forma di "F" con lato 2 mm**  
utilizzato per marcare un riferimento sul lato stromale del lembo per DMEK, prelevato da donatore

## F shaped marker for DMEK EVO line

**"F" shaped marker** with 2 mm tips, to mark the stromal side of the donor lenticle in DMEK procedures



J2183.18A



## DOPPIO UNCINO PER DMEK/DSEK

Doppio uncino per stripping della membrana di Descemet nel paziente e per clivaggio/peeling su cornea donatore

## DOUBLE ENDED HOOK FOR DMEK/DSEK

Double ended hook for the stripping of the recipient's Descemet membrane and for the cleavage/peeling of the donor cornea

## JDMEK SCORING-STRIPPING DMEK/DSAEK SET

5 PER BOX STERILE

### set composto da/composed set:

Uncino "scoring" DSEK/DSAEK, acuto, angolato / DSEK/DSAEK "scoring" hook sharp, angled

Uncino "stripper" DSEK/DSAEK, apice a "T" per rimuovere la membrana di Descemet


DSEK/DSAEK "stripper", "T" shaped tip to remove the Descemet membrane



## DOPPIO MARCATORE/DOUBLE-END MARKER

JDS2296.20/5

5 PER BOX STERILE



Doppio marcatore corneale  
per DMEK/DSEK, Ø 8.00 mm, Ø 9.00 mm

Double-ended corneal marker for  
DMEK/DSEK, Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm

## JD0013 EYE BANK DESCemet PEELING SET MONOUSO

5 PER BOX STERILE

### set composto da/composed set:

L'uncino di sezione triangolare con apice atraumatico svolge la funzione di clivaggio al margine del lenticolo precedentemente fissato sulla base a suzione. Una volta definito lo spessore della membrana di pura Descemet, la pinza J2892 esegue lo scollamento sotto l'azione di peeling.

Delicate blunt hook for Descemet membrane cleavage. The Fogla hook, with atraumatic tips, triangular shaped, performs the cleavage at the edges of the lenticle previously secured to the suction DMEK support. Once the correct thickness of the pure Descemet membrane is achieved, the Janach forceps J2892 performs the detachment by means of the peeling action



La pinza con branche anatomiche afferra al margine la membrana fissata sul supporto a suzione che dolcemente viene scollata sotto un'azione di peeling. Il lenticolo scollato viene poi immerso nella soluzione prima di essere inserito nel paziente.

Lo scollamento del margine si ottiene utilizzando l'uncino di clivaggio J2891E

Forceps with tips anatomically designed for the stripping/peeling of the delicate Descemet membrane. The forceps grasp the membrane at the edge and perform the detachment of the Descemet lenticle by means of a peeling action.


At this step the membrane is secured to its support by the suction system. Cleavage of the membrane is performed with the Fogla hook J2891E



# SPECULUM

FOR ILLUMINATION  
AND INFUSION TUBING GUIDE

J2031.24



Blefarostato regolabile, a valve aperte da 14 mm, con alloggiamenti per il posizionamento di cannelli/vie per infusione e fibre ottiche

Adjustable speculum, 14mm open blades,  
with supports for illumination and infusion  
Designed by A.G. Russo


J2031.21  
P.Vinciguerra M.D.



Blefarostato regolabile, **reverse a valve piene**  
da 14 mm in titanio. Linea VIP


Adjustable speculum, **reverse, 14 mm solid blades**, titanium. VIP line

J2031.12  
Lieberman



Blefarostato regolabile in titanio,  
**valve aperte da 13 mm**

J2031.13  
Lieberman



Blefarostato regolabile in titanio,  
**valve aperte anatomiche da 13 mm**



Titanium adjustable speculum,  
**13 mm open blades**

J2032  
Buratto M.D.




Blefarostato regolabile per LASIK,  
**valve piene anatomiche da 13 mm**



Adjustable speculum, for LASIK,  
**13 mm anatomic solid blades**

J2031  
Buratto M.D.




Blefarostato regolabile,  
**valve aperte anatomiche da 14 mm**



Adjustable speculum,  
**14 mm V-shaped anatomic blades**

## CORNEAL FORCEPS AND SUTURING FORCEPS


J3272.2E



Pinza corneale, delicata,  
con **1x2 denti retti** da **0.12 mm**,  
**con ppf**, in titanio, manico EVOline

Corneal forceps, delicate, **1x2 straight**,  
**0.12 mm teeth**, **with tying platforms**,  
titanium EVOline handle

J3276.6E



Pinza corneo-sclerale tipo colibrì, con  
**1x2 denti retti**, da **0.20 mm**, **con ppf**,  
in titanio, manico EVOline

Corneal-scleral forceps, colibrì type, **1x2**  
**straight**, **0.12 mm teeth**, **with tying**  
**platforms**, titanium EVOline handle


J3902



Pinza corneale tipo colibrì, con **1x2 denti retti** da  
0.12 mm, con ppf, in titanio

Colibri corneal forceps, **1x2 straight**, 0.12 mm  
teeth, with tying platform, titanium


J3291  
Tubingen



Pinza corneale, con **1x2 denti retti**  
da **0.20 mm**, **con ppf**

Corneal forceps, **1x2 straight**, **0.20 mm teeth**,  
**with tying platform**

J3912




Pinza corneale, delicata, con **1x2 denti retti**  
da **0.10 mm**, **con ppf**, in titanio

Corneal forceps, delicate, **1x2 straight**,  
**0.10 mm teeth**, **with tying platform**, titanium

## HOSKIN-PIERCE TIPS


J3926



Pinza corneale, **retta**, presa atraumatica,  
da **0.30 mm**, **con ppf**, in titanio

Corneal forceps, **straight**, **0.30 mm**, atraumatic  
grip, pierce tips, **with tying platform**, titanium

J3927



Pinza corneale, curva, presa atraumatica,  
da **0.20 mm**, **con ppf**, in titanio

Corneal forceps, curved, 0.20 mm, atraumatic  
grip, pierce tips, **with tying platform**, titanium

## SUTURING FORCEPS

**J3311**  
Bores



Pinza da sutura corneale, **angolata**,  
a **forma di U**, interspazio 3 mm,  
con **1x2 denti obliqui** da **0.20 mm**

Corneal suturing forceps, **angled, U-shaped**,  
3 mm spread, **1x2 oblique, 0.20 mm teeth**


**J3312**  
Polack



Pinza per sutura corneale, interspazio 1 mm,  
**1x2 denti obliqui** da **0.12 mm**

Corneal suturing forceps,  
1 mm spread, **1x2 oblique, 0.12 mm**

**J3902.1**  
Polack/Pierce-Hoskin



Pinza per sutura corneale tipo colibrì, manico  
piatto e presa di tipo **Pierce-Hoskin**, da **0.20 mm**

Colibrì suturing forceps, flat handle  
**0.20 mm Pierce-Hoskin tips**

## ANELLI DI FLIERINGA

**J2090.1**




Anello di Flieringa diametro mm **14**  
Flieringa ring, **14 mm**

**J2090.4**



Anello di Flieringa diametro mm **20**  
Flieringa ring, **20 mm**

**J2090.2**



Anello di Flieringa diametro mm **16**  
Flieringa ring, **16 mm**

**J2090.5**



Anello di Flieringa diametro mm **22**  
Flieringa ring, **22 mm**

**J2090.3**



Anello di Flieringa diametro mm **18**  
Flieringa ring, **18 mm**

**J2090.6**



Anello di Flieringa diametro mm **24**  
Flieringa ring, **24 mm**

## TRAPANO CORNEALE PER CHERATOPLASTICA LAMELLARE TETTONICA CORNEAL TREPHINE FOR LAMELLAR TECTONIC KERATOPLASTY

Trapano corneale per cheratoplastica lamellare tettonica, pre calibrato a 250  $\mu$  (micron). Questa tipologia di trapano per ricevente si rende utile nei casi di ampie deformazioni corneali. **Gamma disponibile a partire da Ø 10.00 mm sino a 13.00 mm, con scarto di 0.50**

Corneal trephine, for lamellar tectonic keratoplasty, preset depth at 250  $\mu$  (micron). It is a recipient trephine, used in cases of wide corneal deformations. **Available Ø range 10,00 mm – 13,00 mm with 0,5 mm steps**

### Part numbers and Ø range

**J5670.1** lama, Ø 10.00 mm

**J5670.2** lama, Ø 10.50 mm

**J5670.3** lama, Ø 11.00 mm

**J5670.4** lama, Ø 11.50 mm

**J5670.5** lama, Ø 12.00 mm

**J5670.6** lama, Ø 12.50 mm

**J5670.7** lama, Ø 13.00 mm



# CORNEAL SCISSORS

safety DALK scissors

J1620



Microforbice **SINISTRA** per tecnica DALK,  
con **lama inferiore piatta da 9 mm**.  
Consente la protezione della Descemet

DALK scissors with **flattened lower  
9 mm blades, LEFT**. It allows better protection  
of the Descemet membrane


J1621

Microforbice **DESTRA** per tecnica DALK

DALK scissors **RIGHT**

conventional  
keratoplasty scissors

J1610  
Katzin



Forbice corneale per cheratoplastica,  
**molto curva**, lame da **6 mm**, **DESTRA**

Corneal keratoplasty scissors, **curved,  
6 mm blades**, blunt tips, **RIGHT**

J1612  
Katzin

Forbice corneale per cheratoplastica **SINISTRA**

Corneal keratoplasty scissors **LEFT**

J4211



Micro forbice corneale, **delicata, curva, smussa**  
lunghezza lame da **7 mm**

Corneal scissors, **delicate, slightly curved,  
7 mm blunt tips**


J4223



Forbice per capsulotomia, **poco curva,**  
**punte smusse**, lame da **8 mm**

Capsulotomy scissors, **slightly curved,  
8 mm long, delicate blades, blunt tips**

J4200  
Vannas



Forbice per iride, **RETTA, smussa**, lame da **6 mm**

Iris scissors, **STRAIGHT, 6 mm blades, blunt tips**

J4201

Forbice per iride, **CURVA, smussa**, lame da **6 mm**

Iris scissors, **CURVED, 6 mm blades, blunt tips**

J1552



Forbice per iride, **CURVA, punte acute,**  
lame delicate da **4 mm**

Iris scissors, **CURVED, 4 mm  
long delicate blades, pointed tips**

## SPOONS

J2107  
Paton



Spatola e cucchiaio per lembo corneale

Spatula and spoon for corneal button

J2114.67A



Doppio strumento, cucchiaio forato e spatola tonda. Cucchiaio 8 fori, Ø 11, lunghezza spatola 12

Double instrument, spoon with holes on one side and rounded spatula on the other. Spoon 8 holes, Ø 11, spatula length 12

J2114.62A



Cucchiaio per lembo corneale, satinato. 8 fori, Ø 11

Spoon for corneal button, satin. 8 holes, Ø 11

## CORNEAL MARKERS

J2293.2



Marcatore corneale, 8 raggi Ø interno 4.5 mm

Corneal marker, inner Ø 4.5 mm, with 8 blades

J2293.4



Marcatore corneale, 16 raggi

16 blades


J2293.24  
Vinciguerra



Marcatore corneale, 24 raggi Ø interno 6 mm

Corneal marker, inner Ø 6 mm, with 24 blades

J2296.20



Doppio marcatore corneale per DSEK, Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm

Double-ended corneal marker for DSEK, Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm

## ADDITIONAL TOOLS

J2112A  
Vinciguerra



Spatola per depitelizzazione PRK, consigliata anche per procedure di DSEK/DSAEK, SLAM e Pterigio Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm

e.janach

Epithelium removal spatula, for PRK, also suggested for DSEK/DSAEK, SLAM and Pterygium procedures

J2180.20A  
Pellegrini




Uncino per il tensionamento delle suture rilasciabili, nelle procedure di PK e DALK. Utilizzabile anche per manipolare le IOL e Pterigio Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm

e.janach

Adjustable hook for sutures, useful in PK and DALK procedures. Can be used for IOL manipulation as well SLAM and Pterygium procedures

# NEEDLE HOLDERS & TYING FORCEPS


J3207  
Tennant



Pinza serrafilel CURVA, con piani da 7 mm

Tying forceps, CURVED,  
with 7 mm tying platform


J3207.1



RETTA, con piani da 6 mm

STRAIGHT, with 6 mm tying platform


J3276.1E



Pinza serrafilel, ANGOLATA, con piani da 11 mm.  
Consigliata per l'impianto di lenti rigide,  
in titanio, manico EVOline

Tying forceps, ANGLED, with 11 mm tying  
platform. Recommended for implantation of  
rigid lenses, titanium EVOline handle


J3272.1E



Pinza serrafilel per sutura corneale, RETTA,  
con piani delicati da 6 mm. Consigliata per  
suture da 8-0 a 11-0, in titanio, manico EVOline

Tying forceps, STRAIGHT, with 6 mm tying  
platforms, very delicate. Recommended for 8-0  
to 11-0 sutures, titanium EVOline handle

J3277  
Troutman



Pinza serrafilel e per punti, con piani delicati  
da 6 mm, RETTA

Tying and stitch forceps,  
with delicate 6 mm tying platform, STRAIGHT


J3278  
Troutman



Pinza serrafilel e per punti, con piani delicati da 6  
mm, CURVA. Per punti di nylon e monofilamento.  
Consigliata per suture da 8-0 a 10-0

Tying and stitch forceps, with delicate 6 mm tying  
platform, CURVED. For nylon and monofilament  
sutures. Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

J3150  
Bonn




Pinza serrafilel, RETTA, con piani da 4 mm.  
Consigliata per suture da 8-0 a 10-0

Tying forceps, STRAIGHT, with 4 mm tying  
platform. Recommended for 8-0 to 10-0 suture

## PINZE SERRAFILI / TYNG FORCEPS


J3207.2  
Jaffe



Pinza serrafile, delicata, **RETTA**, smussa, con piani da 6 mm. Consigliata per suture da 8-0 a 11-0

Tying forceps, delicate, **STRAIGHT**, blunt tips, with 6 mm tying platform. Recommended for 8-0 to 11-0 sutures


J3207.3  
Jaffe



Pinza serrafile, delicata, **CURVA**, smussa, con piani da 6 mm. Consigliata per suture da 8-0 a 11-0

Tying forceps, delicate, **CURVED**, blunt tips, with 6 mm tying platform. Recommended for 8-0 to 11-0 sutures

J3290  
Tubingen



Pinza serrafile, **RETTA**, con piani delicati da 4 mm. Consigliata per suture da 8-0 a 10-0

Tying forceps, **STRAIGHT**, 4 mm tying platform, delicate. Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

J3292  
Tubingen



Pinza serrafile, **CURVA**, con piani delicati da 4 mm. Consigliata per suture da 8-0 a 10-0

Tying forceps, **CURVED**, 4 mm tying platform, delicate. Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

## JCP0008 SET PER SUTURA/SUTURING KIT

5 PER BOX STERILE

set composto da/composed set:

pinza serrafile / tying forceps  
bisturi 22.5° / 22.5° knife  
porta aghi / needle holder



# PORTE'AGHI / NEEDLE HOLDER

J3214



Pinza Mc. Pherson/needle holder,  
cross action in titanio

Mc. Pherson/needle holder,  
cross action forceps, titanium

J4191  
Troutman



Port'aghi in acciaio, per sutura corneale, curvo,  
senza arresto, con piani delicati, da **103** mm.  
Consigliato per suture da **8-0 a 10-0**

Stainless steel needle holder, curved, without  
lock, with delicate jaws, overall length: **103** mm.  
Recommended for **8-0 to 10-0** sutures

J4195



Port'aghi in acciaio, per sutura corneale, curvo,  
senza arresto, con piani delicati, da **120** mm.  
Consigliato per suture da **8-0 a 10-0**

Stainless steel needle holder, curved, without  
lock, with delicate jaws, overall length: **120** mm.  
Recommended for **8-0 to 10-0** sutures

J4199E  
P. Vinciguerra

Port'aghi, lunghezza **125** mm, curvo, con  
sistema "**Twister**"(anti-incarcerazione della  
sutura), in titanio. Nuova impugnatura con  
tipologia di chiusura "**a pinza**" che riduce la  
corsa nel movimento di chiusura, rispetto  
al classico sistema a molla.  
Consigliato per suture da **8-0 a 10-0**

SnagFree Twister needle holder, delicate tips,  
overall length: **125mm**, titanium.  
New handle with "**Cross-action forceps style**"  
mechanism which reduces the stroke of the  
closing action compared to the traditional  
spring system By Vinciguerra M.D.  
Recommended for **8-0 a 10-0** sutures



Port'aghi Twister, curvo, da **128** mm,  
anti-incarcerazione, punte delicate, titanio.  
Consigliato per suture da **10-0 a 11-0**



SnagFree Twister needle holder,  
delicate tips,overall length: **128** mm, titanium.  
Recommended for **10-0 to 11-0** sutures

J4198



Port'aghi Twister, curvo, da **128** mm,  
anti-incarcerazione, titanio.  
Consigliato per suture da **7-0 a 9-0**

SnagFree Twister needle holder, curved,  
overall length: **128** mm, titanium.  
Recommended for **7-0 to 9-0** sutures

## PORTE'AGHI / NEEDLE HOLDER

**J4081**  
Castroviejo



Port'aghi in acciaio, curvo,  
senza arresto, da **118 mm**.  
Consigliato per suture da **6-0 a 8-0**

Stainless steel needle holder, curved, without  
lock, overall length: **118 mm**.  
Recommended for **6-0 to 8-0** sutures

**J4121**  
Troutman



Port'aghi in acciaio, curvo,  
senza arresto, da **115 mm**.  
Consigliato per suture da **8-0 a 10-0**

Stainless steel needle holder, curved, without  
lock, overall length: **115 mm**.  
Recommended for **8-0 to 10-0** sutures

**J4055**  
Barraquer



Port'aghi in acciaio, curvo, fine,  
senza arresto, da **135 mm**.  
Consigliato per suture da **10-0 a 11-0**

Stainless steel needle holder, curved, thin,  
without lock, overall length: **135 mm**.  
Recommended **10-0 to 11-0** sutures

**J3968**  
Barraquer



Port'aghi corneale, delicato, retto, senza arresto,  
da **135 mm**, in titanio.  
Consigliato per suture da **10-0 a 11-0**

Needle holder, delicate, straight, without lock,  
overall length: **135 mm**, titanium.  
Recommended for **10-0 to 11-0** sutures

**J3969**



Port'aghi corneale, delicato, curvo,  
senza arresto, in titanio.  
Consigliato per suture da **10-0 a 11-0**


Needle holder, delicate, curved,  
without lock, titanium.  
Recommended for **10-0 to 11-0** sutures

# JCP0005 CXL CROSS LINKING DISPOSABLE SET


5 PER BOX STERILE



set composto da/composed set:

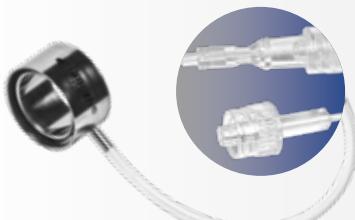

Siringa a molla con anello a suzione, monouso / Single use vacuum syringe with disposable suction ring




Blefarostato monouso con valve aperte da 15 mm. Consigliato per uso diagnostico e chirurgico. L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente


Wire speculum disposable 15 mm blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures. The wide frame allows easy placement and removal



Spatola per depitelizzazione, monouso / Spatula for epithelium removal, disposable



Marcatore per zona ottica, Ø 9.0 mm, monouso / Corneal marker, Ø 9.0 mm, disposable



Telo 75x60 cm, in materiale biaccoppiato con foro ovale 6x9 cm  
Standard drape 75x60 cm,  
with oval incision film 6x9 cm



Tamponi triangolari in PVA con manico,  
2 confezioni da 5 pezzi sterili  
PVA spears, triangular , with handle,  
2 pack of 5 spears each, sterile

## JD2654 DISPOSABLE VACUUM SYRINGE

5 PER BOX STERILE

siringa a molla monouso, con tubo in silicone e raccordo  
**da usare con anello riutilizzabile J2294**

disposable vacuum syringe with tubing set  
**to be used with J2294 reusable ring**



## J2294 CXL CROSS LINKING REUSABLE RING

anello per procedura CXL, risterilizzabile, per un posizionamento stabile sulla cornea. Elimina fuoriuscite del prodotto evitando irritazioni ed emorragie subcongiuntivali, garantendo la perfetta riproducibilità dell'intervento.

**Utilizzare con siringa a suzione monouso JD2654**

reusable CXL soaking ring for cross-linking procedure. Allows for easy, quick and steady positioning on the cornea, eliminates fluid leakage, avoids subconjunctival irritations and haemorrhages assures accurate repeatability of the procedure.

**To be used with disposable vacuum syringe JD2654**

designed by P. Vinciguerra M.D.



# JCP0007 CXL CROSS LINKING DISPOSABLE SET

5 PER BOX STERILE

## set composto da/composed set:

anello a suzione per procedura cross linking (CXL), con siringa a molla.  
Utilizzabile anche come contenitore per procedura LASEK

Cross Linking (CXL) set. Includes suction ring and vacuum syringe.  
Can be used as alcohol well in LASEK procedure



**J2641.60**

Cannula 27G, flat, foro superiore da 0.4 mm,  
per somministrazione riboflavina in  
procedura CXL SUB-EPITELIALE e  
procedura DALK per creazione bolla

Cannula 27G, flat, 0.4 mm upper hole, for  
application of riboflavin in SUB-EPITHELIAL CXL  
procedure and DALK procedure.  
Designed by D. Borroni M.D.



**J2112.1E**  
**HOCKEY-SPATULA**



Micro spatula con profilo trattato smusso. Utile  
nella preparazione del lenticolo donatore per  
determinare il clivaggio nella fase che precede lo  
scollamento del piano pre-descemetic. La spatola  
consente di controllare correttamente lo  
scollamento periferico dei piani in entrambe le  
procedure di preparazione: DALK e DMEK

Micro spatula with beveled edges. Useful in the  
preparation of the donor lenticle to outline the  
cleavage prior to the detachment of the pre-  
descemetic plane. The spatula allows you proper  
control of the peripheral detachment of the  
planes in both DALK and DMEK procedures  
Designed by V. Sarnicola, MD



**JD4801.1/10**

10 PER BOX STERILE

Anello in silicone, monouso

Silicone ring, disposable

## SET PER PRELIEVO DONATORE / DONOR EXCISION SET

**Ø 16**


**J3740**



Supporto rotativo per lama,  
modello M. Campanelli

Blade holder,  
designed by M. Campanelli

**J3716**



Lama prelievo cornea, Ø 16 mm,  
modello M. Campanelli

Donor Blade, Ø 16 mm,  
designed by M. Campanelli

**J3750**



Fissabulbo/centratore per lama da prelievo  
(da utilizzare con lama da Ø 16 mm, J3716)

Fixation ring and guide for blade  
(to be used with Ø 16 mm blade, J3716)

**Ø 17**


**J3740**



Supporto rotativo per lama,  
modello M. Campanelli

Blade holder,  
designed by M. Campanelli

**J3717**



Lama prelievo cornea, Ø 17 mm,  
modello M. Campanelli

Donor Blade, Ø 17 mm,  
designed by M. Campanelli

**J3750.1**



Fissabulbo/centratore per lama da prelievo  
(da utilizzare con lama da Ø 17 mm, J3717)

Fixation ring and guide for blade  
(to be used with Ø 17 mm blade, J3717)

**Ø 18**

**51-905-18**




Lama prelievo cornea, Ø 18 mm, monouso  
(da utilizzare senza supporto)

Donor Blade, Ø 18 mm, disposable  
(no blade holder required)



**J3688**



Pinza per prelevamento lenticolo donatore dal  
liquido di conservazione, con 1x2 denti retti  
da 0.20 mm

Forceps for picking up donor cornea from flask,  
1x2 straight, 0.20 mm teeth

# SLAM PROCEDURE SUTURELESS AMNIOTIC MEMBRANE

Set per preparazione ed innesto membrana amniotica a fissaggio con colla di fibrina senza punti di sutura. La tecnica promuove la ricrescita epiteliale e la riparazione delle perdite di sostanza a livello stromale. Indicata in ulcere neurotrofiche, traumi e patologie epiteliali  
VIDEO JANACH.IT

Set for preparation and graft of amniotic membrane patch using fibrin glue for sutureless fixation. This technique promotes epithelial re-growth and regeneration of stromal tissue. Recommended for neurotrophic ulcers, corneal trauma and epithelial pathologies

**J3740**



Supporto rotativo per lama,  
modello M. Campanelli

Blade holder,  
designed by M. Campanelli

**Ø 13**

**J3713**



Lama da Ø 13 mm per patch,  
modello M. Campanelli

Patch blade, Ø 13 mm,  
designed by M. Campanelli

**J4375**



Supporto per lenticolo di membrana amniotica,  
in silicone, sterilizzabile

Silicone disc for amniotic membrane,  
reusable

**J2292**

**Sivelli-Azzolini**



Ring per fissaggio del patch di membrana  
amniotica

Patch fixation ring

**J3764**

**Sivelli-Azzolini**



Pinza ad azione incrociata per movimentazione  
e posizionamento del patch di membrana  
amniotica

Cross-action forceps for holding and  
positioning the amniotic membrane patch

**J2935**

**Sivelli-Azzolini**



Applanatore per lente a contatto  
post intervento

Post-operative contact lens applanator

## ACCESSORIES



J2231

Cheratometro per astigmatismo intra-operatorio,  
a disco in PSU, autoclavabile, leggero,  
piatto, facile da inserire nei contenitori

PSU intra-operative keratometer for  
astigmatism, reusable, lightweight, flat,  
easy to insert into sterilisation tray



J2294.15  
Maloney

Cheratometro per astigmatismo intra-operatorio,  
autoclavabile, in titanio

Intra-operative keratometer  
for astigmatism, reusable, titanium



J4491  
box of 200 items  
20 pack  
of 10 sterile units

Tamponi triangolari in PVA con manico,  
Freccia assorbente: 100% Poly Vinyl Alchol  
(PVA) in spugna.  
Manico: polipropilene, dimensioni: 3.85 x 53.5 mm

PVA spears with handle, 100% Polyvinyl Alcohol  
(PVA) sponge absorbent arrow.  
Polypropylene handle, dimensions: 3.85 x 53.5 mm



J4496.1  
box of 400 items 20 pack  
of 20 sterile units

Tamponi Viscotex, 5x66 mm.  
**sterile**

Viscotex sponges, 5 x 66 mm.  
**sterile**



J4496.2  
box of 500 items



Tamponi Viscotex, 5x66 mm.  
**non sterile**

Viscotex sponges, 5 x 66 mm.  
**non-sterile**

J4494.1  
20 per box sterile



Protettore corneale in pva,  
diametro da 8 mm

Corneal Light Shield 8mm diameter




J4428  
100 per box sterile

Protettore oculare trasparente  
post intervento, universale, **sterile**  
Eye shield, clear, universal, **sterile**




J4428.0  
Individually packed

Protettore oculare trasparente post intervento,  
universale, **non sterile**  
Eye shield, clear, universal, **non-sterile**

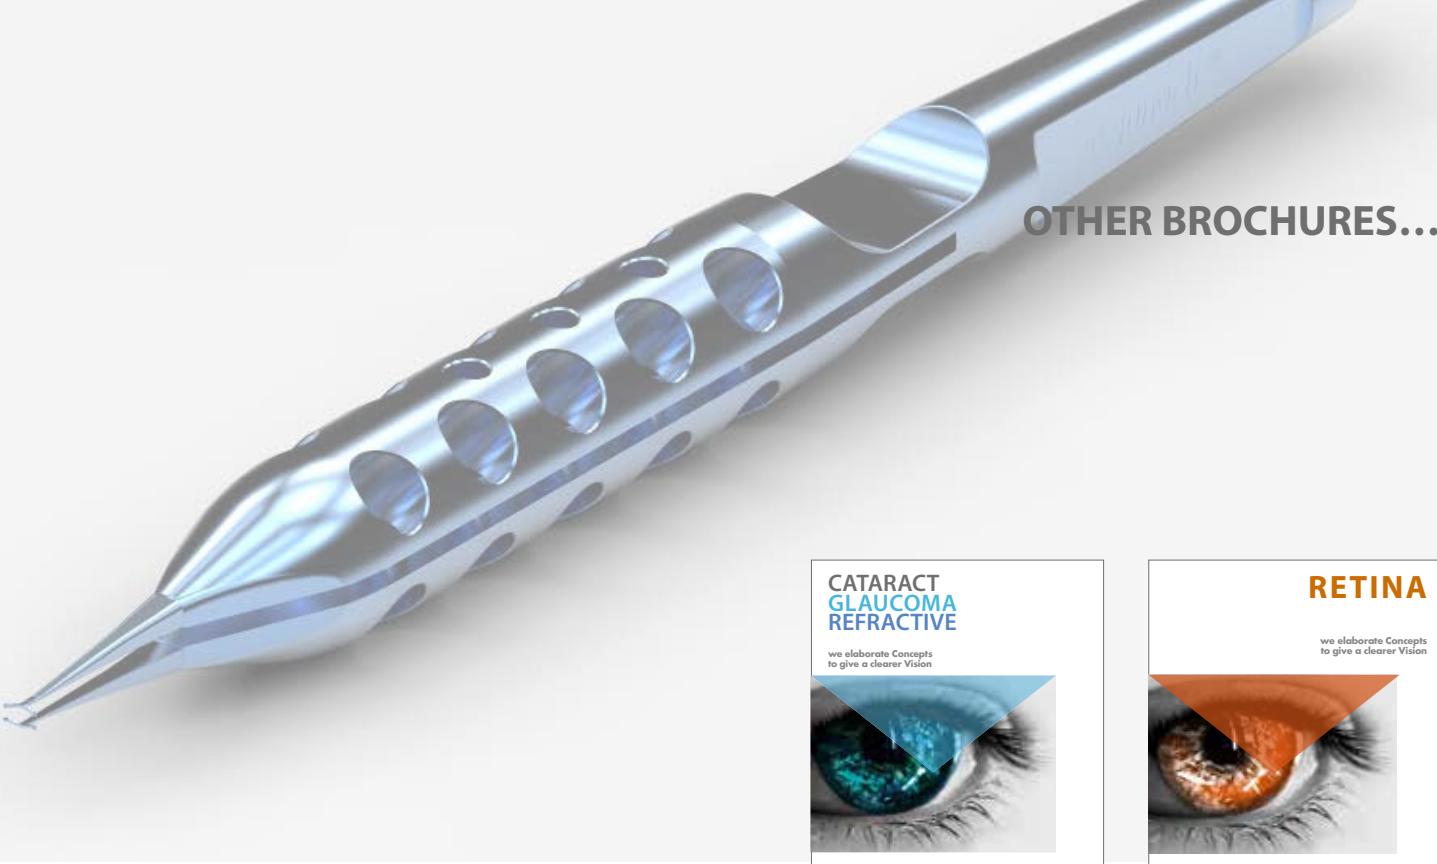

OTHER BROCHURES...

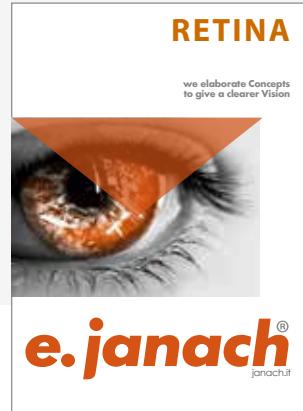

Sistema di  
Qualità Certificato

UNI EN ISO 9001  
UNI CEI EN ISO 13485

Certified  
Quality System

© Copyright:  
E.Janach

**e.janach**  
[www.janach.it](http://www.janach.it)

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy  
Tel. +39 031 574088  
[international@janach.it](mailto:international@janach.it)  
BRO.093.09.21.IT/EN